

Приложение к свидетельству
№ 6116/36 утверждения типа
средств измерений

Всего листов 3
Лист 1

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

ФГУ «Нижегородский ЦСМ»

М.П.

И.И. Решетник

“11” / 10 2010 г.

Манометры избыточного давления грузопоршневые МП – 250	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>18222-99</u> Взамен № _____
---	---

Выпускаются по ГОСТ 8291-83 и техническим условиям ТУ 4212-001-29053968-97.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Манометры избыточного давления грузопоршневые МП-250 классов точности 0,02 и 0,05 в комплекте с устройствами для создания давления предназначены для измерения избыточного давления, а также для поверки и регулировки эталонных и рабочих пружинных манометров и других манометрических приборов.

Основная область применения – в схемах поверки манометрических приборов метрологических служб.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия прибора основан на уравнивании измеряемого давления, действующего на поршень, массой грузов, накладываемых на грузоприемное устройство.

Манометр МП-250 состоит из колонки грузопоршневой измерительной, комплектов грузов и устройства для создания давления.

Колонка грузопоршневая измерительная состоит из цилиндра и притертого к нему поршня с грузоприемным устройством. Между цилиндром и поршнем отсутствуют механические уплотнения, а радиальный зазор между ними, заполненный рабочей жидкостью, составляет от 2 до 4 мкм при выпуске из производства.

Грузоприемное устройство выполнено в виде цилиндра, имеющего внизу фланец, на который опираются грузы. Манометры заполняются трансформаторным маслом по ГОСТ 10121-76 или ГОСТ 982-80.

В состав устройства для создания давления входят запорные вентили, стойки поверяемых приборов, насос и пресс.

Манометры предназначены для работы при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 10)^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80%.




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра
Верхний предел измерений МПа (кгс/см ²)	25 (250)
Нижний предел измерений МПа (кгс/см ²)	0,5 (5)
Пределы допускаемой основной погрешности, %: - при давлениях от 10 до 100% от верхнего предела измерений класс точности 0,05 класс точности 0,02 - при давлениях ниже 10% от верхнего предела измерений класс точности 0,05 класс точности 0,02	$\pm 0,05\%$ от измеряемого давления $\pm 0,02\%$ от измеряемого давления $\pm 0,05\%$ от 0,1 верхнего предела измерений $\pm 0,02\%$ от 0,1 верхнего предела измерений
Номинальное значение приведенной площади поршня, см ²	0,2
Допускаемое отклонение действительного значения приведенной площади поршня от номинального, %, не более	$\pm 1,0$
Максимальная скорость опускания поршня, мм/мин., не более класс точности 0,05 класс точности 0,02	0,5 0,4
Минимальная продолжительность вращения поршня, мин., не менее класс точности 0,05 класс точности 0,02	3 5
Номинальное значение массы поршня с грузоприемным устройством, кг, не более	$1,0 \times 0,98$
Питание от сети переменного тока: - напряжение, В	220^{+22}_{-33}
Габаритные размеры, мм, не более класс точности 0,05 класс точности 0,02	$1070 \times 550 \times 770$ $833 \times 534 \times 676$
Масса, кг, не более класс точности 0,05 класс точности 0,02	117 177
Наработка на отказ, ч	40000
Средний срок службы не менее, лет	7

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус прибора методом металлографии и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

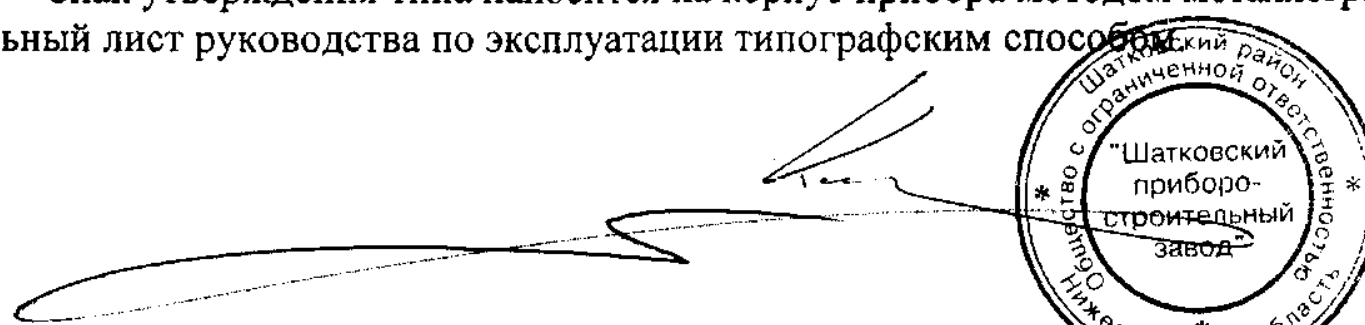

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки манометров соответствует таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество	Примечание
Колонка грузопоршневая измерительная	1	
Устройство для создания давления	1	
Наборы грузов	1 комплект	
Комплект сменных частей и принадлежностей	1	По заказу
Руководство по эксплуатации	1	

ПОВЕРКА

Поверка манометров производится по ГОСТ 8.479-82 "Манометры избыточного давления грузопоршневые. Методы и средства поверки"

Основное поверочное оборудование: грузопоршневой манометр типа МП-600 класса точности 0,005; 0,02.

Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ 8291-83 «Манометры избыточного давления грузопоршневые. Общие технические требования»
- ТУ 4212-001-29053968-97 "Манометры избыточного давления грузопоршневые МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-600; МП-2500; МП-250".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип "Манометры избыточного давления грузопоршневые МП-250 " утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ООО "Шатковский приборостроительный завод"
Адрес: 607700 р.п. Шатки. Нижегородской обл., ул. Центральная, дом 7
 Тел./Факс (83190) 4-10-99, 4-10-06
 E-mail: sh.p.z@yandex.ru

Генеральный директор
 ООО "Шатковский приборостроительный завод"

А.В.Камышев

