

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

УТВЕРЖДАЮ  
Директор БелГИМ

В.Л. Гуревич

2018



Счетчики газа диафрагменные СГМН-1	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № <u>РБ 03 07 0273 18</u>
---------------------------------------	---

Выпускают по ТУ BY 100185185.232-2013 «СЧЕТЧИКИ ГАЗА ДИАФРАГМЕННЫЕ СГМН-1» (взамен ТУ РБ 07526946.050-95, ТУ РБ 14541426.013-98).

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики газа диафрагменные СГМН-1 (далее счетчики) предназначены для измерения израсходованного количества природного газа по ГОСТ 5542 или паров сжиженного углеводородного газа по СТБ 2262, а также, других неагрессивных газов, применяемых в бытовых и производственных целях.

Область применения - объекты социального и культурно-бытового назначения, жилые дома.

## ОПИСАНИЕ

Счетчик состоит из двух камер, внутренние полости которых разделены газонепроницаемыми диафрагмами. Диафрагмы перемещаются за счет разницы давления газа на входе и выходе счетчика и приводят во вращение отсчетное устройство, находящееся на лицевой панели счетчика.

Структура полного обозначения счетчиков в зависимости от исполнения:

СГМН-1x-x-Gx

- Наличие дополнительного устройства;
- Расстояние между осями штуцеров;
- Направление потока газа;
- Номинальный расход.

По наличию дополнительного устройства:

- СГМН-1-x-x-Gx – без дополнительного устройства;
- СГМН-1И-x-x-Gx – с устройством импульсного выхода;
- СГМН-1R-x-x-Gx – с устройством беспроводной передачи данных;

По расстоянию между осями штуцеров:

- 1 – расстояние между осями штуцеров 250 мм;
- 2 – расстояние между осями штуцеров 200 мм;

По направлению потока газа:

- 1 – направление потока газа левое;
- 2 – направление потока газа правое;

По номинальному расходу:

- 4 – номинальный расход типоразмера G4;
- 6 – номинальный расход типоразмера G6.



Счетчики исполнений СГМН-1И-х-х-Gx, СГМН-1R-х-х-Gx могут быть встроены в единую систему автоматизированного сбора и обработки информации.

По устойчивости и прочности к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчики должны соответствовать группе исполнения С4 по ГОСТ 12997, но для эксплуатации в зависимости от варианта исполнения при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С или от минус 40 °С до плюс 60 °С.

По стойкости к термическому воздействию окружающей среды счетчики относятся к II классу (алюминиевый корпус) по СТБ 1159.

Наибольшее избыточное рабочее давление счетчиков – 60 кПа.

Условное обозначение вариантов исполнения счетчиков приведено в приложении А.

Направление потока газа обозначено стрелкой на крышке счетчика.

Внешний вид счетчиков представлен на рисунке 1- 3.

Место нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки приведено в приложении Б к описанию типа.

Пломба с оттиском знака поверки расположена под пломбой предприятия (Приложение Б).

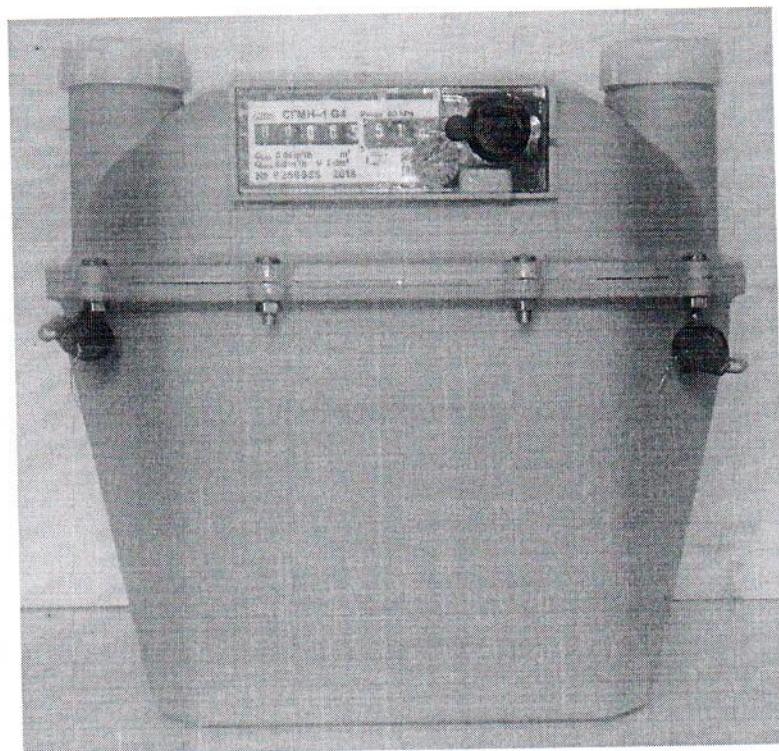


Рисунок 1 - Общий вид счетчиков газа СГМН-1х-х-х-Gx

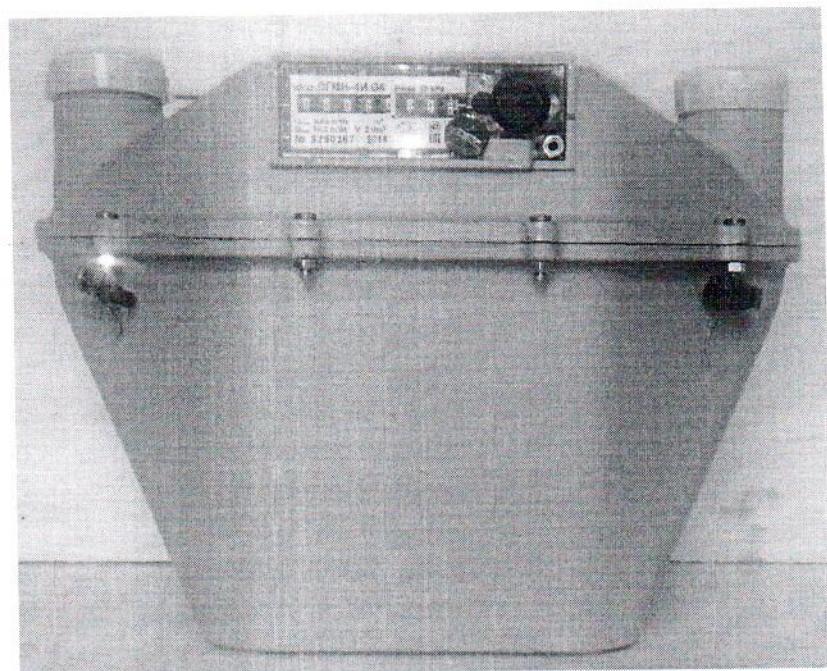


Рисунок 2 - Общий вид счетчиков газа СГМН-1И-х-х-Gx

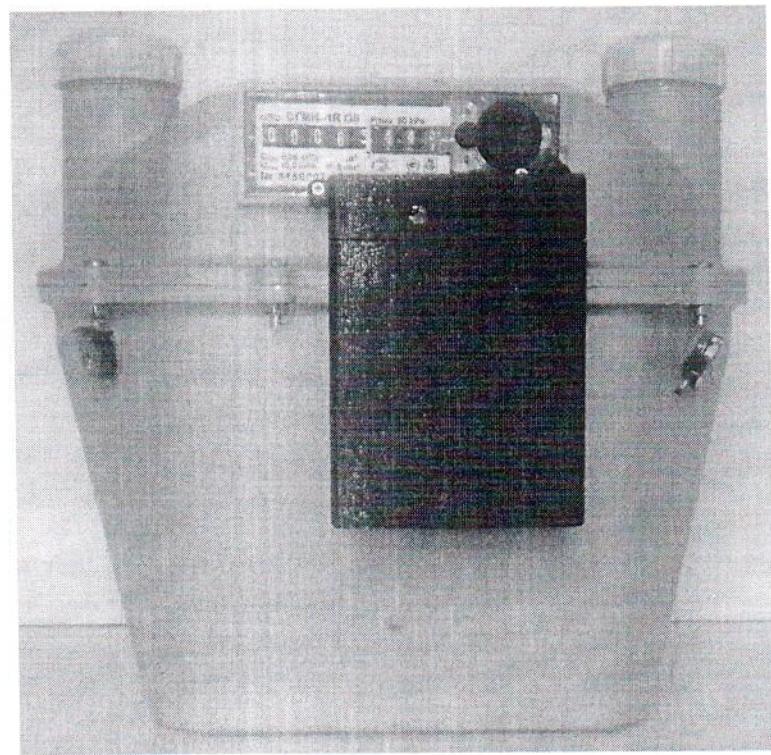


Рисунок 3 - Общий вид счетчиков газа СГМН-1R-х-х-Gx



# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры счетчиков приведены в таблице 1

Таблица 1

Наименование	Значение			
	G4		G6	
СГМН-1-1-1-G4 СГМН-1-1-2-G4 СГМН-1И-1-1-G4 СГМН-1R-1-1-G4 СГМН-1R-1-2-G4	СГМН-1-2-1-G4 СГМН-1-2-2-G4 СГМН-1И-2-1-G4 СГМН-1И-2-2-G4 СГМН-1R-2-1-G4 СГМН-1R-2-2-G4	СГМН-1-1-1-G6 СГМН-1-1-2-G6 СГМН-1И-1-1-G6 СГМН-1R-1-1-G6 СГМН-1R-1-2-G6	СГМН-1-2-1-G6 СГМН-1-2-2-G6 СГМН-1И-2-1-G6 СГМН-1И-2-2-G6 СГМН-1R-2-1-G6 СГМН-1R-2-2-G6	
Номинальный расход ( $Q_{\text{ном}}$ ), $\text{м}^3/\text{ч}$	4			6
Минимальный расход ( $Q_{\text{мин}}$ ), $\text{м}^3/\text{ч}$ , не более	0,04			0,06
Максимальный расход ( $Q_{\text{макс}}$ ), $\text{м}^3/\text{ч}$ , не менее	6			10
Допускаемая потеря давления на счетчике при номинальном расходе ( $\Delta P_{Q \text{ nom}}$ ), Па, не более	80			125
Допускаемая потеря давления на счетчике при максимальном расходе ( $\Delta P_{Q \text{ макс}}$ ), Па, не более	200			250
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более	310×165×225 (310×195×225)*	265×165×245 (265×195×245)*	310×165×225 (310×195×225)*	265×165×245 (265×195×245)*
Расстояние между осями штуцеров, мм	$250 \pm 0,5$	$200 \pm 0,5$	$250 \pm 0,5$	$200 \pm 0,5$
Масса, кг, не более	3,8	3,3	3,8	3,3
Резьба на присоединительных штуцерах, трубная по ГОСТ 6357	$G1\frac{1}{4}$			

\* Для счетчиков исполнений СГМН-1R

Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика при выпуске из производства и после ремонта:

± 3 % в диапазоне расходов от  $Q_{\text{мин}}$  до  $0,1 Q_{\text{ном}}$ ;

± 1,5 % в диапазоне расходов свыше  $0,1 Q_{\text{ном}}$  до  $Q_{\text{макс}}$ .

Пределы допускаемой основной относительной погрешности в процессе эксплуатации:

± 5 % в диапазоне расходов от  $Q_{\text{мин}}$  до  $0,1 Q_{\text{ном}}$ ;

± 3 % в диапазоне расходов свыше  $0,1 Q_{\text{ном}}$  до  $Q_{\text{макс}}$ .

Дополнительная относительная погрешность счетчиков, вызванная отклонением температуры измеряемого газа от нормальной ( $20 \pm 3$ ) °C, по сравнению с основной относительной погрешностью не превышает ± 0,45 % при изменении температуры на 1 °C.

Порог чувствительности счетчиков не более  $0,002 Q_{\text{ном}}$ .

Циклический объем счетчиков – 2  $\text{dm}^3/\text{об}$ .

Один импульс соответствует объему  $0,01 \text{ м}^3$  прошедшего через счетчик газа.

Электрические характеристики цепи устройства импульсного выхода:

- напряжение  $U_{\text{max}} \leq 12 \text{ В}$ ,
- сила тока  $I_{\text{max}} \leq 10 \text{ мА}$ .

Технические характеристики модуля беспроводной передачи данных и сервисные программы согласно ТУ производителю.



Счетчик является прочным и герметичным при воздействии внутреннего избыточного давления в 1,5 раза превышающего наибольшее избыточное рабочее давление.

Конструкция соединительных элементов счетчика обеспечивает прочность и герметичность при присоединении счетчика к подводящему газопроводу при воздействии внутреннего давления в 1,5 раза превышающего наибольшее избыточное рабочее давление, изгибающего момента 110 Н·м и крутящего момента 340 Н·м.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевой панели счетчика методом тампопечати и в паспорте типографским способом.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.
Счетчик газа диафрагменный СГМН-1х-х-х-Gx	1
Крышка	2
Переходник (Сталь ГОСТ 380 или ГОСТ 1050)*	2
Гайка (Чугун КЧ 30-6-Ф ГОСТ 1215)*	2
Прокладка (Резина МБС ГОСТ 7338)*	2
Коробка (Упаковка)	1
Паспорт	1
Штекер**	1
Заглушка**	1
Фильтр ***	1
Методика поверки МРБ МП.1778-2008****	1

\* Входят в комплект счетчиков, планируемых к применению на территории Республики Беларусь и по требованию заказчика  
\*\* Входят в комплект счетчиков с импульсным выходом по требованию заказчика.  
\*\*\* Входит в комплект счетчиков по требованию заказчика  
\*\*\*\* Поставляется специализированным газораспределительным организациям

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ BY 100185185.232-2013 «Счетчики газа диафрагменные СГМН-1» (взамен ТУ РБ 07526946.050-95, ТУ РБ 14541426.013-98).

СТБ 1159 – 99 «Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования и методы испытаний».

СТБ 8011 – 99 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики газа. Методика поверки»

МРБ МП.1778-2008 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики газа СГМН-1, СГД-1, СГД-3Т, СГД 4. Методика поверки».



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики газа диафрагменные СГМН-1 соответствуют требованиям ТУ BY 100185185.232-2013, СТБ 1159-99.

Межпроверочный интервал – не более 96 месяцев

Научно-исследовательский центр испытаний средств измерений и техники  
БелГИМ

г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13

Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО». Почтовый адрес: 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23, тел. 267-11- 90

Начальник научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники БелГИМ

Д.М. Каминский

Заместитель генерального директора-главный инженер ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»



Д.В. Михальцов



**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)  
**ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ**

Таблица А.1

Условное обозначение варианта исполнения	Обозначение основного конструкторского документа	Габаритные размеры, мм	Расстояние между осями штуцеров, мм	Масса, кг	Бандажи BANDAGE NOKTURNEHNE TANPAERNEHE MOTORKA LA3A	Левое Правое
СГМН-1-1-1-G6	1009.00.00.000;	-12 <sup>1)</sup> ; -30 <sup>2)</sup> ; -40 <sup>3)</sup> ; -50 <sup>4)</sup> ; -60 <sup>5)</sup>	310x165x225	250	3,8	1
СГМН-1-1-2-G6	-02;	-32 <sup>2)</sup> ; -42 <sup>3)</sup>			2	Правое
СГМН-1-2-1-G6	-04;	-08 <sup>1)</sup> ; -34 <sup>2)</sup> ; -44 <sup>3)</sup> ; -54 <sup>4)</sup> ; -64 <sup>5)</sup>	265x165x245	200	3,3	1
СГМН-1-2-2-G6	-06;	-10 <sup>1)</sup> ; -36 <sup>2)</sup> ; -46 <sup>3)</sup> ; -56 <sup>4)</sup> ; -66 <sup>5)</sup>			2	Правое
СГМН-1И-1-1-G6	-20;	-80 <sup>5)</sup>	310x165x225	250	3,8	1
СГМН-1И-2-1-G6	-21;	-81 <sup>5)</sup>	265x165x245	200	3,3	1
СГМН-1И-2-2-G6	-22;	-82 <sup>5)</sup>			2	Правое
СГМН-1-1-1-G4	-01;	-13 <sup>1)</sup> ; -31 <sup>2)</sup> ; -41 <sup>3)</sup> ; -51 <sup>4)</sup> ; -61 <sup>5)</sup>	310x165x225	250	3,8	1
СГМН-1-1-2-G4	-03;	-33 <sup>2)</sup> ; -43 <sup>3)</sup>			2	Правое
СГМН-1-2-1-G4	-05;	-09 <sup>1)</sup> ; -35 <sup>2)</sup> ; -45 <sup>3)</sup> ; -55 <sup>4)</sup> ; -65 <sup>5)</sup>	265x165x245	200	3,3	1
СГМН-1-2-2-G4	-07;	-11 <sup>1)</sup> ; -37 <sup>2)</sup> ; -47 <sup>3)</sup> ; -57 <sup>4)</sup> ; -67 <sup>5)</sup>			2	Правое
СГМН-1И-1-1-G4	-23;	-83 <sup>5)</sup>	310x165x225	250	3,8	1
СГМН-1И-2-1-G4	-24;	-84 <sup>5)</sup>	265x165x245	200	3,3	1
СГМН-1И-2-2-G4	-25;	-85 <sup>5)</sup>			2	Правое

1) Вариант исполнения счетчиков без присоединительных элементов (переходник - 2 шт., гайка - 2 шт., прокладка - 2 шт.);

2) Вариант исполнения счетчиков с диапазоном рабочих температур от минус 40 °C до плюс 60 °C;

3) Вариант исполнения счетчиков с комплектацией фильтром;

4) Вариант исполнения счетчиков с диапазоном рабочих температур от минус 40 °C до плюс 60 °C и без присоединительных элементов (переходник - 2 шт., гайка - 2 шт., прокладка - 2 шт.);

5) Вариант исполнения счетчиков с комплектацией клапаном термозапорным.



Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7
СГМН-1R-1-1-G6	1009.00.00.000-70	310x195x225	250	3,8	1	Левое
СГМН-1R-1-2-G6	-71				2	Правое
СГМН-1R-2-1-G6	-72	265x195x245	200	3,3	1	Левое
СГМН-1R-2-2-G6	-73				2	Правое
СГМН-1R-1-1-G4	-74	310x195x225	250	3,8	1	Левое
СГМН-1R-1-2-G4	-75				2	Правое
СГМН-1R-2-1-G4	-76	265x195x245	200	3,3	1	Левое
СГМН-1R-2-2-G4	-77				2	Правое



**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(обязательное)  
Места пломбирования и клеймения

Место нанесения знака поверки  
в виде клейма-наклейки

Место пломбирования и  
нанесения оттиска знака поверки

