

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15611 от 3 октября 2022 г.

Срок действия до 22 февраля 2027 г.

Наименование типа средств измерений:
Уровнемеры радарные ЭЛМЕТРО-РПУ

Производитель:
ООО «ЭлМетро Групп», г. Челябинск, Российская Федерация

Документ на поверку:

первичная государственная поверка проводится по:

АМПД.407.624.168 МП «Государственная система обеспечения единства измерений.

Уровнемеры радарные ЭЛМЕТРО-РПУ. Методика поверки»;

последующая государственная поверка проводится по:

СТБ 8047-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений.

Уровнемеры автоматические. Методика поверки» (при поверке в лабораторных условиях);

СТБ ISO 4266-2016 «Нефть и жидкие нефтепродукты. Измерения уровня

и температуры в резервуарах для хранения с применением автоматических методов.

Часть 1. Измерение уровня в резервуарах при атмосферном давлении» (при поверке

на резервуарах)

Интервал времени между государственными поверками:

уровнемеры с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня не более ± 3 мм: 12 месяцев;

уровнемеры с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня свыше ± 3 мм: 36 месяцев

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 03.10.2022 № 93

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 3 октября 2022 г. № 15611

Наименование типа средств измерений и их обозначение: уровнемеры радарные ЭЛМЕТРО-РПУ

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: в соответствии с таблицей 2 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: в соответствии с таблицей 3 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 4 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Первичная государственная поверка осуществляется по документу АМПД.407.624.168 МП «ГСИ. Уровнемеры радарные ЭЛМЕТРО-РПУ. Методика поверки», утвержденному в 2021 г., последующая государственная поверка осуществляется по СТБ 8047-2015 «Уровнемеры автоматические. Методика поверки» (при поверке в лабораторных условиях); по СТБ ISO 4266-2016 «Нефть и жидкие нефтепродукты. Измерения уровня и температуры в резервуарах для хранения с применением автоматических методов. Часть 1. Измерение уровня в резервуарах при атмосферном давлении» (при поверке на резервуарах).

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:
требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Программное обеспечение: в соответствии с разделом «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений:
в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенные по тексту Приложения ссылки на документы «Р 50.2.077-2014»,
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 30 декабря 2019 г. № 3459 «Об утверждении Государственной поверочной
схемы для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов»
для Республики Беларусь носят справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер
и представлена на рисунке 1 Приложения.

Место нанесения знака поверки: на свидетельство о поверке.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер:
№ 84697-22, на 9 листах.

Директор БелГИМ

A.V. Казачок



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «22» февраля 2022 г. № 432

Регистрационный № 84697-22

Лист № 1
Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Уровнемеры радарные ЭЛМЕТРО-РПУ

Назначение средства измерений

Уровнемеры радарные ЭЛМЕТРО-РПУ (далее – уровнемеры) предназначены для измерений уровня жидких, вязких и сыпучих сред, а также преобразований измерительной информации в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока.

Описание средства измерений

Принцип действия уровнемеров основан на частотном методе измерений расстояния при помощи радиолокатора непрерывного излучения с частотной модуляцией (FMCW). Во время измерений радиолокатор посыпает высокочастотный сигнал, частота излучения которого линейно возрастает. Излучаемый сигнал отражается от поверхности измеряемой среды и принимается антенной. В электронном блоке уровнемера с помощью быстрого преобразования Фурье определяется разница между частотами отраженного и излучаемого сигналов в текущий момент времени, которая прямо пропорциональна расстоянию до поверхности среды. Измеренное расстояние пересчитывается в уровень заполнения резервуара, объём или массу жидкости в резервуаре. Полученное значение уровня отображается на индикаторе и (или) передается по цифровым проводным или беспроводным интерфейсам связи. Также в зависимости от модификации уровнемера полученное значение уровня преобразуется в аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока.

Конструктивно уровнемеры состоят из электронного блока и антенны, расположенных в едином корпусе. Электронный блок может иметь в своем составе клавиатурно-индикаторный модуль, обеспечивающий локальный интерфейс пользователя. Конструкция антенны может быть рупорной, линзовой или штыревой.

Уровнемеры монтируются вертикально над поверхностью измеряемой среды. Уровнемеры измеряют расстояние между базовой плоскостью, которой является уплотнительная поверхность присоединительного фланца или поверхность уплотнения, и поверхностью измеряемой среды.

Уровнемеры имеют в своем составе 3-х осевой акселерометр для вычисления углов отклонения оси уровнемера от вертикали. Измеренные акселерометром значения могут использоваться как для контроля корректности монтажа уровнемера, так и для вычисления уровня продукта при установке уровнемера под углом к горизонтальной плоскости.

Измерительная и диагностическая информация отображается на индикаторе, а также передается в систему верхнего уровня (контроллер, персональный компьютер, автоматическая система управления предприятия) через цифровые интерфейсы связи (RS-485 или HART) или с помощью аналогового выходного сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА. Беспроводной интерфейс связи Bluetooth используется для настройки прибора с помощью мобильного приложения.

Структурная схема условного обозначения модификаций уровнемеров:

ЭЛМЕТРО-РПУ-Х₁-Х₂Х₃Х₄Х₅-Х₆-Х₇Х₈Х₉-Х₁₀Х₁₁

ЭЛМЕТРО-РПУ – обозначение типа уровнемеров.

Х₁ – Исполнение уровнемера:

«0» – общепромышленное исполнение.

Х₂ – Максимальное значение диапазона измерений и преобразований уровня, м:

«A» – 3;

«B» – 10;

«C» – 20;

«D» – 30.

Х₃ – Диапазон температур рабочей среды, °С:

«S» – от -60 до +80;

«C» – от -200 до +80;

«H» – от -60 до +200.

Х₄ – Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня, мм:

«H» – ±1;

«M» – ±3;

«L» – ±5;

«P» – ±10.

Х₅ – Максимальное избыточное давление рабочей среды, МПа:

«P» – 0,3;

«L» – 1,6;

«M» – 4,0.

Х₆ – Диапазон температур окружающей среды, °С:

«0» – от -40 до +80;

«C» – от -50 до +80;

«E» – от -60 до +80.

Х₇ – Тип интерфейса связи:

«A» – RS-485;

«B» – RS-485 и Bluetooth;

«C» – RS-485 и аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока от 4 до 20 мА (HART);

«D» – RS-485, аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока от 4 до 20 мА (HART) и Bluetooth.

Х₈ – Наличие клавиатурно-индикаторного модуля:

«0» – отсутствует;

«D» – присутствует.

Х₉ – Диапазон(ы) напряжения(й) питания:

«S» – от 18 до 36 В от сети постоянного тока;
«U» – от 195 до 265 В от сети переменного тока с частотой (50±1) Гц и от 230 до 370 В от сети постоянного тока.

X₁₀X₁₁ – Тип антенны (различные типы отличаются габаритами рупора, штыря и линзы соответственно). Индекс X₁₀ отвечает за буквенное обозначение, X₁₁ – за указанную цифру:

«H1» – Антенна рупорная типа 1;
«H2» – Антенна рупорная типа 2;
«H3» – Антенна рупорная типа 3;
«H4» – Антенна рупорная типа 4;
«H5» – Антенна рупорная типа 5;
«H6» – Антенна рупорная типа 6;
«H7» – Антенна рупорная типа 7;
«H8» – Антенна рупорная типа 8;
«H9» – Антенна рупорная типа 9;

«R1» – Антенна штыревая типа 1;
«R2» – Антенна штыревая типа 2;
«R3» – Антенна штыревая типа 3;
«R4» – Антенна штыревая типа 4;
«R5» – Антенна штыревая типа 5;
«R6» – Антенна штыревая типа 6;
«R7» – Антенна штыревая типа 7;
«R8» – Антенна штыревая типа 8;
«R9» – Антенна штыревая типа 9;

«L1» – Антенна линзовая типа 1;
«L2» – Антенна линзовая типа 2;
«L3» – Антенна линзовая типа 3;
«L4» – Антенна линзовая типа 4;
«L5» – Антенна линзовая типа 5;
«L6» – Антенна линзовая типа 6;
«L7» – Антенна линзовая типа 7;
«L8» – Антенна линзовая типа 8;
«L9» – Антенна линзовая типа 9.

Заводской номер наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе уровнемеров, любым технологическим способом в виде цифрового кода.

Общий вид уровнемеров представлен на рисунке 1. Цвета корпуса могут быть изменены в зависимости от условий заказа.

Для защиты от несанкционированного доступа к настройкам уровнемера предусмотрена защита паролем. Нанесение знака поверки на уровнемеры в обязательном порядке не предусмотрено. Пломбирование уровнемеров не предусмотрено.



Рисунок 1 – Общий вид уровнемеров

Программное обеспечение

Уровнемеры имеют встроенное и внешнее программное обеспечение (далее – ПО). Встроенное ПО является метрологически значимым. Метрологические характеристики уровнемеров нормированы с учетом влияния встроенного ПО. Встроенное ПО записывается в энергонезависимую память уровнемеров предприятием-изготовителем и не доступно для изменения пользователем. Доступ к встроенному ПО и изменение метрологически значимых параметров возможны только при помощи специализированного ПО предприятия-изготовителя и защищены паролем.

Встроенное ПО предназначено для обработки результатов измерений, настройки и самодиагностики уровнемеров.

Внешнее ПО «RadarConfig», устанавливаемое на персональный компьютер, предназначено для отображения результатов измерений, проверки работоспособности и настройки уровнемеров.

Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «средний» в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные встроенного ПО уровнемеров представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные встроенного ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	-
Номер версии (идентификационный номер ПО)	Не ниже 1.1.0
Цифровой идентификатор ПО	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики уровнемеров

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны измерений уровня, м, для модификаций:	
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -АХ ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -НХ ₁₁	от 0,3 до 3
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -ВХ ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -НХ ₁₁	от 0,3 до 10
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -СХ ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -НХ ₁₁	от 0,3 до 20
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -DX ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -НХ ₁₁	от 0,3 до 30
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -AX ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -RX ₁₁ и ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -AX ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -LХ ₁₁	от 0,6 до 3
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -BX ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -RX ₁₁ и ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -BX ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -LХ ₁₁	от 0,6 до 10
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -CX ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -RX ₁₁ и ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -CX ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -LХ ₁₁	от 0,6 до 20
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -DX ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -RX ₁₁ и ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -DX ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -LХ ₁₁	от 0,6 до 30

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня при считывании измерительной информации с индикатора и через цифровые интерфейсы, мм, для модификаций:	
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -Х ₂ Х ₃ НХ ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -Х ₁₀ X ₁₁	±1
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -Х ₂ Х ₃ МХ ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -Х ₁₀ X ₁₁	±3
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -Х ₂ Х ₃ ЛХ ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -Х ₁₀ X ₁₁	±5
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -Х ₂ Х ₃ РХ ₅ -Х ₆ -Х ₇ Х ₈ Х ₉ -Х ₁₀ X ₁₁	±10
Диапазон выходного аналогового сигнала силы постоянного тока, мА, для модификаций:	
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -Х ₂ Х ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -СХ ₈ Х ₉ -Х ₁₀ X ₁₁	от 4 до 20
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -Х ₂ Х ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -DX ₈ Х ₉ -Х ₁₀ X ₁₁	
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований уровня) погрешности преобразований цифрового сигнала в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, %, для модификаций:	
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -Х ₂ Х ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -СХ ₈ Х ₉ -Х ₁₀ X ₁₁	±0,03
– ЭЛМЕТРО-РПУ-Х ₁ -Х ₂ Х ₃ Х ₄ Х ₅ -Х ₆ -DX ₈ Х ₉ -Х ₁₀ X ₁₁	

Таблица 3 – Основные технические характеристики уровнемеров

Наименование характеристики	Значение
Диапазон температур рабочей среды, °С, для модификаций:	
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ SX ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -X ₁₀ X ₁₁	от -60 до +80
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ CX ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -X ₁₀ X ₁₁	от -200 до +80
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ HX ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -X ₁₀ X ₁₁	от -60 до +200
Максимальное избыточное давление рабочей среды, МПа, не более, для модификаций:	
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ PX ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -X ₁₀ X ₁₁	0,3
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ LX ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -X ₁₀ X ₁₁	1,6
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ MX ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -X ₁₀ X ₁₁	4,0
Протоколы обмена данными	Modbus RTU HART
Напряжение питания постоянного тока, В, для модификаций:	
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ S-X ₁₀ X ₁₁	от 18 до 36
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ U-X ₁₀ X ₁₁	от 230 до 370
Параметры питания переменного тока для модификации ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ U-X ₁₀ X ₁₁ :	
– напряжение, В	от 195 до 265
– частота, Гц	от 49 до 51
Габаритные размеры, мм, не более, для модификаций ¹⁾ :	
ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -HX ₁₁	
– длина	253
– ширина	173
– высота	512
ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -RX ₁₁	
– длина	253
– ширина	173
– высота	350
ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -LX ₁₁	
– длина	253
– ширина	173
– высота	350
Масса без фланца, кг, не более, для модификаций ¹⁾ :	
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -HX ₁₁	4,6
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -RX ₁₁	2,5
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -X ₆ -X ₇ X ₈ X ₉ -LX ₁₁	6,6
Рабочие условия измерений:	
– температура окружающей среды, °С, в зависимости от модификации:	
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -0-X ₇ X ₈ X ₉ -X ₁₀ X ₁₁	от -40 до +80
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -C-X ₇ X ₈ X ₉ -X ₁₀ X ₁₁	от -50 до +80
– ЭЛМЕТРО-РПУ-X ₁ -X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ -E-X ₇ X ₈ X ₉ -X ₁₀ X ₁₁	от -60 до +80 (по индивидуальному заказу)

Наименование характеристики	Значение
– относительная влажность окружающего воздуха при температуре окружающей среды +40 °C, %	до 95
Средняя наработка на отказ, ч	100000
Средний срок службы, лет	12
1) При наличии термоудлинителя и прочих аксессуаров габаритные размеры и масса могут быть увеличены.	

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом и на маркировочную табличку, расположенную на корпусе уровнемеров, любым технологическим способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Уровнемер радарный ЭЛМЕТРО-РПУ	-	1 шт.
Комплект запасных частей ¹⁾	-	1 компл.
Вспомогательные принадлежности ¹⁾	-	1 компл.
Паспорт	АМПД.407624.168 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	АМПД.407624.168 РЭ	1 экз. ²⁾
Методика поверки	АМПД.407624.168 МП	1 экз. ²⁾

¹⁾ По заказу.

²⁾ Допускается прилагать 1 экземпляр на партию уровнемеров в одном заказе или поставлять на электронном носителе.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе «НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» руководства по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к уровням радарным ЭЛМЕТРО-РПУ

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 года № 3459 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов»

ГОСТ 28725-90 «Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Общие технические требования и методы испытаний»

АМПД.407624.168 ТУ «Уровнемеры радарные ЭЛМЕТРО-РПУ. Технические условия»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлМетро Групп» (ООО «ЭлМетро Групп»)

Адрес деятельности: 454106, Челябинская обл. Челябинск, ул. Наглинная, д. 21, пом. 106

Место нахождения и адрес юридического лица: 454106, Челябинская обл. Челябинск, ул. Наглинная, д. 21, пом. 106


ИНН 7448092141

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области метрологии» (ООО «ИЦРМ»)

Место нахождения и адрес юридического лица: 117546, г. Москва, Харьковский проезд, д.2, этаж 2, пом. I, ком. 35,36

Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311390 от 18.11.2015 г.

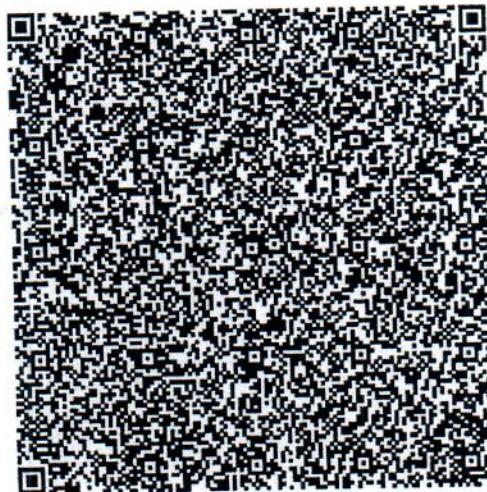

КОПИЯ ВЕРНА
СТАРШИЙ СЛУЖАЩИЙ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ МАРОВЕ А.

Man S