

### Программное обеспечение

В ИП анализатора имеется встроенное метрологически значимое программное обеспечение.

Программное обеспечение предназначено для приложения электрического потенциала к электрохимической ячейке и измерения силы возникающего в ней электрического тока.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице.

Таблица 1

Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
VA	не ниже 2.1	499602D2	CRC-32

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с МИ 3286-2010 - С.

### Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений массовой концентрации ионов:

- кадмия ( $\text{Cd}^{2+}$ )
- свинца ( $\text{Pb}^{2+}$ )
- меди ( $\text{Cu}^{2+}$ )
- цинка ( $\text{Zn}^{2+}$ )

от 0,5 до 500 мкг/дм<sup>3</sup>  
от 0,5 до 500 мкг/дм<sup>3</sup>  
от 1 до 500 мкг/дм<sup>3</sup>  
от 10 до 500 мкг/дм<sup>3</sup>

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массовой концентрации ионов в диапазонах

- от 0,5 до 10 мкг/дм<sup>3</sup>
- от 10 до 500 мкг/дм<sup>3</sup>

± 25 %  
± 20 %

Диапазон установки поляризующего напряжения

от минус 2000 до  
плюс 2000 мВ

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки поляризующего напряжения

± 10 мВ

Диапазоны измерения силы тока

от 0 до 0,2 мкА;  
от 0 до 2 мкА;  
от 0 до 20 мкА;  
от 0 до 200 мкА;  
от 0 до 2000 мкА

Пределы допускаемой погрешности измерения силы тока, приведенной к верхнему значению диапазона измерений

± 5 %

Время выхода на рабочий режим, не более

15 мин

Продолжительность непрерывной работы, не менее

8 ч



Средняя наработка на отказ, не менее	8000 ч
Питание от сети переменного тока	
- частотой	(50 ± 1) Гц
- напряжением	(220 ± 22) В
- через блок питания	220/12 В
- потребляемый ток, не более	0,5 А
Габаритные размеры измерительного преобразователя (длина × ширина × высота), не более	(150×200×60) мм
Масса измерительного преобразователя, не более	1 кг
Рабочие условия применения:	
- температура окружающего воздуха	от 5 до 40 °С
- относительная влажность при температуре 25 °С	не более 90 %
- атмосферное давление	от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации КТЖГ.414314.005 РЭ типографским способом и на нижнюю панель измерительного преобразователя анализатора в виде наклейки.

### Комплектность средства измерений

Таблица 2


Наименование	Обозначение	Количество, шт.	Примечания
Измерительный преобразователь ЭКОТЕСТ-ВА или ЭКОТЕСТ-ВА-4	КТЖГ.414314.005 КТЖГ.414314.005-1	1 1	по заказу по заказу
Электрохимическая ячейка		1	по заказу
Блок питания		1	
Программное обеспечение		1	электронный носитель
Инструкция к программному обеспечению	КТЖГ.414314.005 ПО	1	
Кабель соединительный к ПК	RS 232	1	
Персональный компьютер, IBM-совместимый		1	по заказу
Руководство по эксплуатации	КТЖГ.414314.005 РЭ	1	
Методика поверки	КТЖГ.414314.005 МП	1	

### Поверка

осуществляется в соответствии с документом КТЖГ.414314.005 МП «Анализатор вольтамперометрический ЭКОТЕСТ ВА. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 3 июня 2003 г.

Основное поверочное оборудование:

вольтметр универсальный В7-49 (диапазон измеряемых напряжений от 10<sup>-3</sup> до 200 В, погрешность ± 0,05 %); государственный стандартный образец состава водных растворов ионов свинца ГСО 7778-2000 (погрешность ± 1,0 % при Р = 0,95).

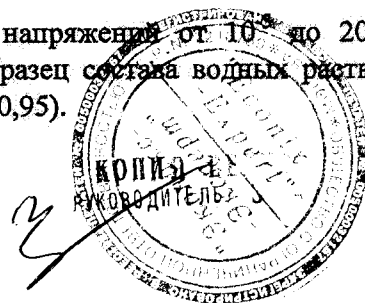

**Сведения о методиках (методах) измерений**

Методы измерений содержатся в Руководстве по эксплуатации КТЖГ.414314.005 РЭ.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к анализаторам вольтамперометрическим ЭКОТЕСТ-ВА**

ГОСТ Р 8.641-2008 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрохимическими методами ионного состава водных растворов (средств измерений рХ)».

ТУ 4215-005-52722949-03 «Анализаторы вольтамперометрические ЭКОТЕСТ-ВА. Технические условия».

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

- при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды.
- при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОНИКС-ЭКСПЕРТ»  
(ООО «ЭКОНИКС-ЭКСПЕРТ»)

Юридический адрес: 117513, Россия, Москва, ул. Академика Бакулева, 6/1.

Почтовый адрес: 117513, Москва, а/я 55.

Телефон/факс: (495) 936-89-41, 936-89-42, 936-89-43.

Электронная почта: [ionomer@ionomer.ru](mailto:ionomer@ionomer.ru).

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»).

Юридический адрес: 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, городское поселение Менделеево, Главный лабораторный корпус.

Почтовый адрес: 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево

Телефон: (495) 744-81-12, факс: (495) 744-81-12

E-mail: [office@vniiftri.ru](mailto:office@vniiftri.ru)

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИФТРИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30002-13 от 07.10.2013 г.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

2014 г.

