

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

№ 14081 от 5 мая 2021 г.

Наименование средства измерений и его обозначение

Комплексы газоаналитические ПЭМ-2М.1

Назначение средства измерений

Комплексы газоаналитические ПЭМ-2М.1 (далее - комплексы) предназначены:

- для отбора, транспортирования и подготовки газовых проб из дымовой трубы для анализа;

- для автоматических непрерывных измерений объемной доли (массовой концентрации) оксида углерода (CO), оксида азота (NO), диоксида азота (NO₂), оксидов азота NO_x (в пересчете на NO₂), диоксида серы (SO₂), диоксида углерода (CO₂), кислорода (O₂), а также температуры газовых выбросов топливосжигающих установок;

- для сбора, хранения и обработки результатов измерений, передачи информации о текущей концентрации измеряемых компонентов от комплекса на внешние регистрирующие устройства по унифицированному цифровому интерфейсу RS485 по протоколу EDP или Modbus RTU.

Комплексы применяются в качестве газоаналитических каналов автоматизированных информационно-измерительных систем контроля выбросов (АИС) с их последующими испытаниями в полном объеме.

Описание средства измерений

Принцип действия комплекса основан на следующих методах измерения:

1) всех компонентов (кроме кислорода) - оптико-абсорбционный в инфракрасной области спектра;

2) кислорода - электрохимический, основан на применении твердоэлектролитного датчика на основе диоксида циркония,

3) температуры - преобразователь термоэлектрический ТХА.

Комплекс является стационарным автоматическим многоканальным средством измерений непрерывного действия.

Конструктивно комплект состоит из модуля основного (МО) и модуля управления пробоотбором (МУП), размещенных в специализированных шкафах.

В состав комплекса входят следующие основные устройства:

- блок аналитический ПЭМ-2М.1 (для определения всех газов, кроме кислорода);

- измерительная камера с датчиком кислорода (БИК - блок измерения кислорода);

- преобразователь термоэлектрический ТХА исполнение 9505 (термопара) для применения в агрессивной среде (регистрационный номер 46538-11);

Примечание: допускается применение другой термопары с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками.

- блок токовых выходов (далее - БТВ) для вывода аналоговых сигналов на вторичные приборы;

- концентратор токовых входов (далее - КТВ) для подключения дополнительного оборудования;

- блок аспирации (далее - БАс);

- соединительный газовый коммутатор (далее - ГК-04) для подключения нескольких точек измерения;

- пробоотборное устройство с зондом (далее - ПУ);

- обогреваемая линия транспортировки пробы (далее - ЛТПП) с внутренней фторопластовой трубкой или с трубкой из нержавеющей стали в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001 и ГОСТ Р ИСО 10396-2012;

- блок пробоподготовки (далее - БПП);

- блок осушки пробы (далее - БОП) (холодильник);

Температура подогреваемой линии поддерживается в диапазоне от плюс 120 °С до плюс 210 °С для предотвращения образования конденсата и растворения в нем растворимых газов.

Пробоподготовка заключается в очистке газовой пробы от механических примесей, охлаждении и осушении пробы.

Анализируемая газовая пробы прокачивается компрессором через зонд, где происходит очистка от механических примесей, далее поступает по обогреваемым линиям через модуль управления пробоотбором в основной модуль, где охлаждается до температуры от плюс 3 °С до плюс 5 °С. При этом происходит конденсация воды (осушение пробы).

Подготовленная таким образом пробы поступает в терmostатированную ячейку аналитического блока (плюс 40 °С).

В датчик кислорода пробы поступает влажная либо осушеннная в зависимости от расположения измерительной камеры датчика кислорода.

В комплексе предусмотрены следующие функции:

- корректировки «нулевых» показаний и чувствительности;

- контроль температуры зонда и линии транспортирования пробы;

- продувки устройства пробоотбора и линии транспортирования пробы при понижении заданной температуры

- обратная продувка газовых линий сжатым воздухом для их очистки от механических примесей

Комплекс имеет следующие входные/выходные сигналы:

- показания дисплея блока аналитического и дисплеев отдельных измерительных модулей кислорода и температуры,

- аналоговый выходы от 0 до 5 mA, от 4 до 20 mA, от 0 до 20 mA (до 8 каналов на 1 точку измерения);

- аналоговые выходы от 0 до 5 mA, от 4 до 20 mA, от 0 до 20 mA (до 8 каналов на 1 точку измерения);

- цифровой выход (интерфейс RS 485).

Примечание:

Комплекс позволяет работать с несколькими точками отбора пробы (не более 8), если это не противоречит требованиям Федерального закона от 21.07.2014 № 219 ФЗ, ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001 и других нормативных документов в части дискретности интервала измерения и времени транспортного запаздывания отбора пробы.

Результаты измерений передаются в цифровом виде через интерфейс RS-485 (на автоматизированное рабочее место оператора (АРМ)) - дополнительно и, при необходимости, в аналоговом виде (на вторичные приборы регистрации) через БТВ.

Измерения концентраций компонентов (кроме кислорода) относят к «сухой» пробе, т.к. вся влага конденсируется и удаляется из пробы. Пересчет измеренных концентраций определяемых компонентов во «влажной» пробе проводится с учетом содержания паров воды в составе АИС.

Кроме того, комплекс имеет индикаторный канал паров воды в пробе на выходе из блока пробоподготовки.

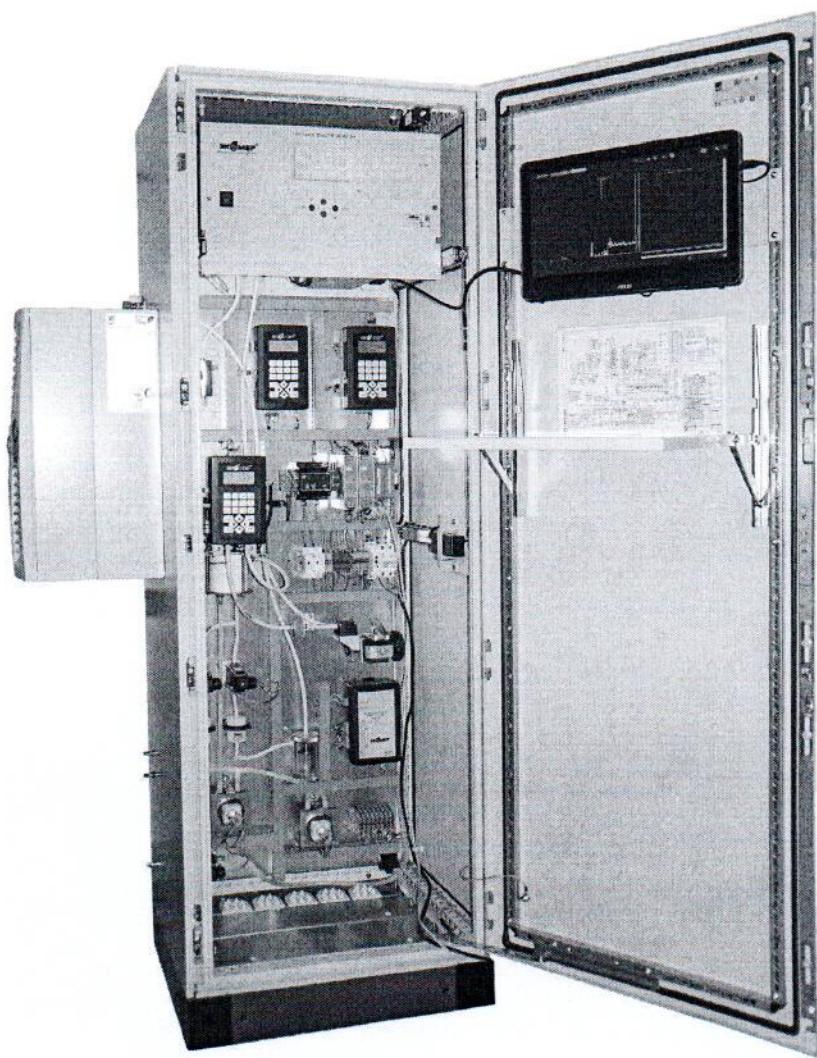


Рисунок 1 - Общий вид комплекса газоаналитического ПЭМ-2М.1 (модуль основной МО)

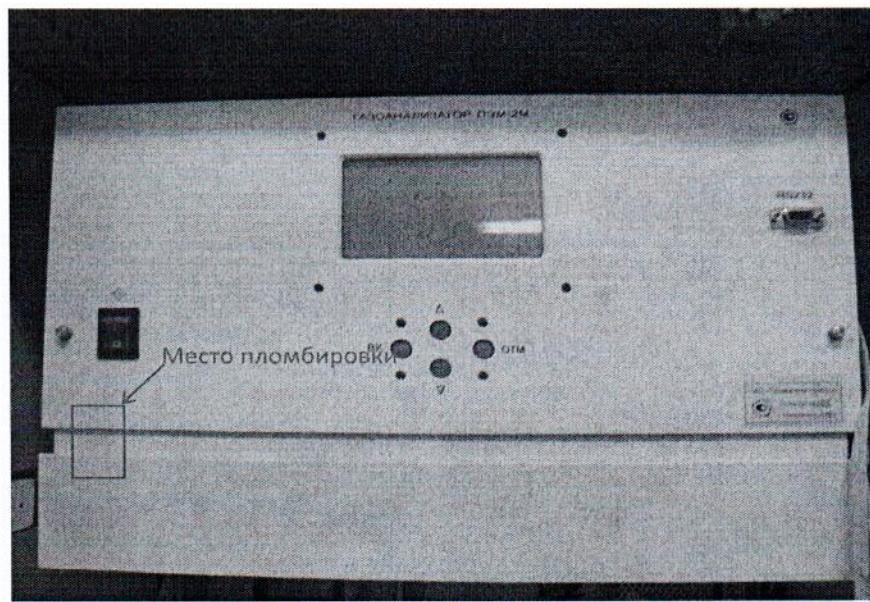


Рисунок 2 - Место пломбировки комплекса

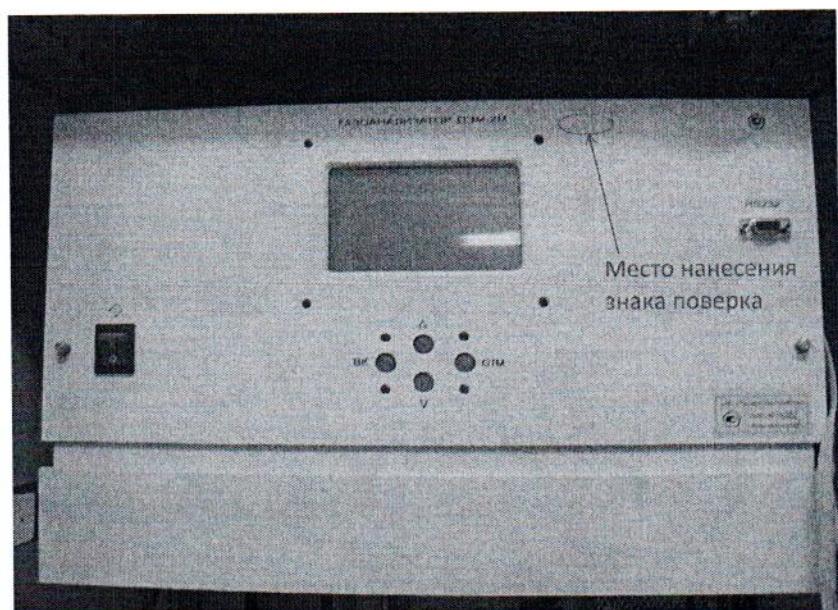


Рисунок 3 - Рекомендуемое место нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Комплексы имеют встроенное программное обеспечение, состоящее из следующих частей:

- встроенное ПО блока аналитического (газоанализатора) ПЭМ-2М.1;
- встроенное ПО контроллера блока пробоподготовки (БПП);
- встроенное ПО контроллера блока осушки пробы (БОП) (холодильника);
- встроенное ПО контроллера БИК (блок измерения кислорода);
- встроенное ПО модуля управления пробоотбором (МУП);
- встроенное ПО концентратора токовых входов (КТВ);
- встроенное ПО блока токовых выходов (БТВ);
- встроенное ПО блока аспирации (БАс).

Программное обеспечение осуществляет функции:

Блок аналитический ПЭМ-2М.1

- расчет содержания компонентов CO, CO₂, NO, NO₂, SO₂ - измерительные каналы;
- передачу информации на удаленный АРМ (опция) и в модуль токовых выходов по цифровому каналу связи;
- отображение концентрации измеренных компонент на встроенном ЖК индикаторе.
- диагностику аппаратной части газоанализатора,
- проведение градуировки аналитического блока.

Контроллер блока пробоподготовки (БПП)

- управляет насосом прокачки пробы, клапанами пробы/нулевого газа.

Контроллер холодильника

- стабилизирует температуру в теплообменнике (от плюс 3 °C до плюс 5 °C);
- измеряет остаточную влажность после теплообменника (индикаторный канал);
- измеряет скорость прокачки пробы/нулевого газа (индикаторный канал).

Контроллер БИК (блок измерения кислорода)

- измеряет содержание O₂ в анализируемой пробе - измерительный канал;
- формирует выходной сигнал постоянного тока пропорциональный содержанию O₂;
- передает информацию о концентрации O₂ в контроллер ПЭМ-2М.1.

Модуль управления пробоотбором (МУП)

- стабилизирует температуру фильтра подогреваемого (ФП);
- стабилизирует температуру линии транспортировки пробы подогреваемой (ЛТПП);
- управляет набором клапанов для обеспечения режима продувки ЛТПП при аварийном снижении температуры ЛТПП и/или ФП.

Концентратор токовых входов (КТВ)

- измеряет аналоговый токовый сигнал от 0 до 20 мА (8 каналов);
- передает измеренные значения по цифровому каналу связи в ПЭМ-2М.1.

Блок токовых выходов (БТВ)

- принимает значения концентраций по цифровому каналу связи от ПЭМ-2М.1;
- формирует выходной сигнал постоянного тока пропорциональный сигналам, переданным контроллером ПЭМ-2М.1 (8 каналов).

Блок аспирации БАс

- управляет набором клапанов для обеспечения режима аспирации (обратной продувки ФП).

Метрологически значимым ПО являются: встроенное ПО контроллера ПЭМ-2М.1, встроенное ПО контроллера БИК (блок измерения кислорода), встроенное ПО концентратора токовых входов (КТВ) и встроенное ПО блока токовых выходов (БТВ).

ПО контроллера блока пробоподготовки (БПП), контроллера холодильника, модуля управления пробоотбором (МУП) и блока аспирации БАс не являются метрологически значимыми.

Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических характеристик газоанализаторов. Уровень защиты - средний по Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблицах 1 - 4.

Таблица 1 - Встроенное ПО блока аналитического (газоанализатора) ПЭМ-2М.1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	OpticGasAnalyzer_16.2.1.bin
Номер версии (идентификационный номер) * ПО	16.2.1
Цифровой идентификатор ПО	717d3da79caa760c4b37e00601d107aa
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

* Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения должен быть не ниже указанного в таблице.

Таблица 2 - Встроенное ПО контроллера БИК (блок измерения кислорода)

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	IKTS_6.14.2
Номер версии (идентификационный номер)* ПО	6.14.2
Цифровой идентификатор ПО	7921e13adf22182ad96c609079107fcc
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

* Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения должен быть не ниже указанного в таблице.

Таблица 3 - Встроенное ПО концентратора токовых входов (КТВ)

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Tok_in_21.1.0
Номер версии (идентификационный номер)* ПО	21.1.0
Цифровой идентификатор ПО	d6c0190bf01c07c8082c9ff9b9684507
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

* Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения должен быть не ниже указанного в таблице.

Таблица 4 - Встроенное ПО блока токовых выходов (БТВ)

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Tok_9.5.0
Номер версии (идентификационный номер)* ПО	9.5.0
Цифровой идентификатор ПО	159dacd192725764a82ec63c8928ee10
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

* Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения должен быть не ниже указанного в таблице.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 5 - Метрологические характеристики измерительных каналов комплекса (аналитический блок с устройством отбора и подготовки пробы)

Измерительный канал (определяемый компонент или параметр)	Диапазон показаний, млн ⁻¹ (объемной доли, %)	Диапазон измерений объемной доли ¹⁾ , млн ⁻¹ (объемной доли, %)	Пределы допускаемой основной погрешности	
			абсолютной	относительной
O ₂	от 0 до 25 % (об.)	от 0 до 5 % (об.) включ. св. 5 до 25 % (об.)	±0,12 % об. -	- ±2,5 %
CO ₂	от 0 до 30 % (об.)	от 0 до 5 % (об.) включ. св. 5 до 30 % (об.)	±0,25 % об. -	- ±5 %
CO	от 0 до 500 млн ⁻¹	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ. св. 50 до 500 млн ⁻¹	±2,5 млн ⁻¹ -	- ±5 %
	от 0 до 2500 млн ⁻¹	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. св. 100 до 2500 млн ⁻¹	±5 млн ⁻¹ -	- ±5 %
SO ₂	от 0 до 500 млн ⁻¹	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ. св. 50 до 500 млн ⁻¹	±4 млн ⁻¹ -	- ±8 %
	от 0 до 3500 млн ⁻¹	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. св. 100 до 3500 млн ⁻¹	±8 млн ⁻¹ -	- ±8 %
NO	от 0 до 500 млн ⁻¹	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ. св. 50 до 500 млн ⁻¹	±4 млн ⁻¹ -	- ±8 %
	от 0 до 1500 млн ⁻¹	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. св. 100 до 1500 млн ⁻¹	±8 млн ⁻¹ -	- ±8 %
NO ₂	от 0 до 500 млн ⁻¹	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ. св. 50 до 500 млн ⁻¹	±4 млн ⁻¹ -	- ±8 %
	от 0 до 1000 млн ⁻¹	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. св. 100 до 1000 млн ⁻¹	±8 млн ⁻¹ -	- ±8 %
NO _x (в пересчете на NO ₂) ²⁾	от 0 до 500 млн ⁻¹	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ. св. 50 до 500 млн ⁻¹	±4 млн ⁻¹ -6	- ±8 %
	от 0 до 2500 млн ⁻¹	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. св. 100 до 2500 млн ⁻¹	±8 млн ⁻¹ -	- ±8 %

Продолжение таблицы 5

Измерительный канал (определеняемый компонент или параметр)	Диапазон показаний, млн^{-1} (объемной доли, %)	Диапазон измерений объемной доли ¹⁾ , млн^{-1} (объемной доли, %)	Пределы допускаемой основной погрешности	
			абсолютной	относительной
Температура анализируемой пробы	от 0 до 900 °C	от 0 до 300 °C включ. св.300 до 900 °C	±4,5 °C -	- ±1,5 %

¹⁾ Пересчет значений объемной доли X в млн^{-1} (ppm) в массовую концентрацию C, $\text{мг}/\text{м}^3$, проводят по формуле:

$$C = X M/V_m,$$

где M - молярная масса компонента, г/моль;

V_m - молярный объем газа-разбавителя - азота или воздуха, равный 22,41, при условиях (0 °C и 101,3 кПа в соответствии с РД 52.04.186-89), $\text{дм}^3/\text{моль}$.

²⁾ Расчетное значение. Массовая концентрация NO_x определяется умножением объемной доли на коэффициент, равный 2,05 (для NO_2)

Таблица 6 - Метрологические характеристики газоаналитических каналов комплекса

Наименование характеристики	Значение
Предел допускаемой вариации показаний, в долях от предела допускаемой основной погрешности	0,5
Пределы допускаемого изменения выходного сигнала за 24 ч непрерывной работы, в долях от предела допускаемой основной погрешности	±0,5
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 °C от номинального значения температуры 20 °C в пределах рабочих условий, в долях от предела допускаемой основной погрешности	±0,5
Пределы суммарной дополнительной погрешности от влияния неизмеряемых компонентов в анализируемой газовой смеси, приведенных в РЭ, в долях от предела допускаемой основной погрешности ¹⁾	±0,2
Время прогрева, мин, не более	60
Предел допускаемого времени установления выходного сигнала ($T_{0,9}$), с (время одного цикла без учета транспортного запаздывания)	180
Нормальные условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность окружающего воздуха, % - диапазон атмосферного давления, кПа	от +15 до +25 от 30 до 80 от 98 до 104,6

¹⁾ Перекрестная чувствительность для определяемых компонентов скомпенсирована введением поправок.

Таблица 7 - Диапазоны измерений и пределы допускаемой суммарной относительной (приведенной) погрешности измерительных каналов системы в условиях эксплуатации (в соответствии с Приказом Минприроды России от № 425 от 07.12.2012 г)

Определяемый компонент	Диапазоны измерений объемной доли определяемого компонента, млн ⁻¹	Пределы допускаемой суммарной абсолютной погрешности, γ, млн ⁻¹	Пределы допускаемой суммарной относительной погрешности, δ, %
Диоксид серы (SO ₂)	от 0 до 30 включ.	±7,5	-
	св. 30 до 500	-	±(25,8-0,027·С) ¹⁾
	от 0 до 50 включ.	±12,5	-
	св. 50 до 3500	-	±(25,2-0,0037·С)
Оксид азота (NO)	от 0 до 30 включ.	±7,5	-
	св. 30 до 500	-	±(25,8-0,027·С)
	от 0 до 50 включ.	±12,5	-
	св. 50 до 1500	-	±(25,4-0,0088·С)
Диоксид азота (NO ₂)	от 0 до 30 включ.	±7,5	-
	св. 30 до 500	-	±(25,8-0,027·С)
	от 0 до 50 включ.	±12,5	-
	св. 50 до 1000	-	±(25,7-0,0134·С)
NO _x (в пересчете на NO ₂) ²⁾	от 0 до 30 включ.	±7,5	-
	св. 30 до 500	-	±(25,8-0,027·С)
	от 0 до 50 включ.	±12,5	-
	св. 50 до 2500	-	±(25,4-0,0088·С)
Оксид углерода (CO)	от 0 до 20 включ.	±5	-
	св. 20 до 500	-	±(25,7-0,036·С)
	от 0 до 40 включ.	±10	-
	св. 40 до 2500	-	±(25,3-0,007·С)

¹⁾С - измеренное значение объемной доли, млн⁻¹.

²⁾ Расчетное значение

Таблица 8 - Габаритные размеры и масса

Наименование	Габаритные размеры, мм, не более				Масса, кг, не более
	ширина	высота	длина	диаметр	
ПУ с ФП	-	-	500	300	15
ПУ с погружным фильтром ¹⁾	-	-	2000	200	5
Пробоотборный зонд	-	-	3000 ²⁾	60	4
МУП без аспирации и подогрева	400	250	600	-	20
МУП с аспирацией и подогревом	600	300	800	-	45
БТВ ПГРА 120.12.14.00	400	250	400	-	13
КТВ ПГРА 200.00.00	250	400	400	-	13

Продолжение таблицы 8

Наименование	Габаритные размеры, мм, не более				Масса, кг, не более
	ширина	высота	длина	диаметр	
Блок аспирации БАс	250	400	680	-	35
Модуль основной МО	550	2000	900	-	210
Блок аналитический ПЭМ-2М.1	470	300	320	-	20
Соединительный газовый коммутатор ГК-04	600	300	800	-	60
Линия транспортировки пробы подогреваемая ЛТПП	-	-	X ³⁾	60	1
Компрессор ⁴⁾	400	750	700	-	70
Блочно-модульное здание КИП	2600	2200	3500	-	2000

¹⁾ без учета массы и габаритных размеров погружаемой части зонда;
²⁾ длина зонда выбирается в зависимости от параметров газохода;
³⁾ суммарная длина и масса ЛТПП зависит от удаленности точки измерения от МО;
⁴⁾ Устанавливается опционально.

Таблица 9 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Электропитание питание - однофазным переменным током частотой 50±1 Гц, напряжением, В	230±23
Потребляемая мощность, кВт, не более	5
Средняя наработка на отказ в условиях эксплуатации, с учетом технического обслуживания, ч (при доверительной вероятности Р=0,95)	24000
Средний срок службы, лет	10

Таблица 10 - Условия эксплуатации

Наименование характеристики	Значение
Параметры окружающей среды: - диапазон температуры окружающей среды, °С - диапазон атмосферного давления, кПа - диапазон относительной влажности окружающего воздуха при температуре +35 °С без конденсации влаги, % - синусоидальные вибрации при частоте 25 Гц амплитудой, мм, не более	от +5 до +40 от 84,0 до 106,7 от 30 до 90 0,1
Параметры газовой пробы на входе в пробоотборное устройство (пробоотборный зонд): - температура анализируемой среды, °С, не более - содержание воды (при температуре не более +200 °С, без конденсации влаги), объемная доля в %, не более - содержание механических примесей, г/м ³ , не более	+900 20 10
Параметры газовой пробы на входе в блок аналитический (после блока пробоподготовки): - диапазон температуры газовой пробы, °С - массовая концентрация паров воды, г/м ³ , не более - содержание механических примесей, мг/м ³ , не более - диапазон расхода газовой пробы, дм ³ /мин	от +3 до +5 8 1 от 2 до 7

Знак утверждения типа

наносится на табличку, закрепленную на дверце шкафа с контроллером методом наклейки и на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским методом.

Комплектность средства измерений

Таблица 11 - Комплектность комплекса газоаналитического ПЭМ-2М.1

Наименование	Обозначение	Количество
Комплекс газоаналитический ПЭМ-2М.1 в составе:	ПГРА 121.00.00.00	
Патрубок переходной	ПГРА 120.21.00	1 ¹⁾
Пробоотборное устройство (ПУ)	ПГРА 107.01.00	1 ¹⁾
Фильтр подогреваемый (ФП)	ПГРА 107.01.01.00	1 ¹⁾
Модуль управления пробоотбором (МУП)	ПГРА 120.20.00;...-13	1 ¹⁾
Линия транспортировки пробы подогреваемая (ЛТПП)	ПГРА 094.00.00	метров ¹⁾
Модуль основной (МО)	ПГРА 121.12.00	1
Вспомогательные устройства:		
Компрессор ²⁾		1
Блочно-модульное здание КИП ³⁾		1
Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) ⁴⁾		1
Блок токовых выходов БТВ ⁴⁾	ПГРА 120.12.14.00	1
Концентратор токовых входов КТВ ⁴⁾	ПГРА 200.00.00	1
Блок аспирации БАс	ПГРА 104.000.000	1
Комплект ЗИП		1
Руководство по эксплуатации	ПГРА 121.00.00.00 РЭ	1
Паспорт	ПГРА 121.00.00.00 ПС	1
Методика поверки	МП-242-2175-2018	1
Компакт-диск с тестовым программным обеспечением ⁴⁾	ПГРА 121.00.00.00 ПО	1

¹⁾ Количество определяется количеством точек отбора пробы, соответствующих требованиям НД по контролю газовых выбросов в части дискретности интервала измерения и времени транспортного запаздывания отбора пробы;

²⁾ Поставляется при отсутствии на объекте сжатого воздуха КИП;

³⁾ Поставляется при эксплуатации комплекса в уличном исполнении;

⁴⁾ Поставляется по желанию заказчика.

Поверка

осуществляется по документу МП-242-2175-2018 «ГСИ. Комплексы газоаналитические ПЭМ-2М.1. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» 15 февраля 2018 г.

Основные средства поверки:

- стандартные образцы состава газовые смеси: ГСО 10597-2015 (O₂/N₂); ГСО 10546-2014 (SO₂/ N₂), (NO₂/N₂), (NO/N₂); ГСО 10531-2014 (CO₂/N₂), (CO/N₂); ГСО 10546-2014 (SO₂/CO/NO/N₂) в баллонах под давлением;

- азот особой чистоты по ГОСТ 9293-74.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам газоаналитическим ПЭМ-2М.1

Приказ Минприроды России от № 425 от 07.12.2012 г. Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений, п.1.2

ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия

ГОСТ Р 50759-95 Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных выбросов. Общие технические условия

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ 8.578-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах

ТУ 4215-009-50570197-2017 Комплекс газоаналитический ПЭМ-2М.1. Технические условия

Изготовитель

Акционерное общество «Проманалитприбор» (АО «Проманалитприбор»)
ИНН 5433132528

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7/34, оф. 23
Телефон/факс: +7 (38341) 279-81, 279-82, 279-78

E-mail: info@Ecomer.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19

Телефон: +7 (812) 251-76-01, факс: +7 (812) 713-01-14

Web-сайт: <http://www.vniim.ru>

E-mail: info@vniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от 23.03.2016 г.

Директор
Республиканского унитарного предприятия
"Белорусский государственный институт метрологии"

В.Л. Гуревич



Гуревич