

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



STATE COMMITTEE FOR
STANDARDIZATION OF THE
REPUBLIC OF BELARUS

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

7013

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

31 марта 2016 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип средств измерений

"Преобразователи измерительные цифровые напряжения постоянного тока ЦВ9057",

изготовитель - **ООО "Энерго-Союз", г. Витебск, Республика Беларусь (BY),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 13 1936 11** и допущен к применению в Республике Беларусь с 31 июля 2003 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета


С.А. Ивлев

31 марта 2011 г.

НТК по метрологии Госстандарта

№

03-2011

31 MAR 2011

секретарь НТК





АННУЛИРОВАН

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

для национального реестра средств измерений

УТВЕРЖДАЮ
Директор РУП «Витебский ЦСМС»П.П.Яковлев
« » 201 г.

Преобразователи измерительные цифровые напряжения постоянного тока ЦВ 9057	Внесены в национальный реестр средств измерений Регистрационный № <u>РБ 03 13 1936 11</u>
--	--

Выпускают по ТУ РБ 300521831.017-2003, УИМЯ.411600.018

ООО «Энерго-Союз», Республика Беларусь

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи измерительные цифровые напряжения постоянного тока ЦВ 9057 (в дальнейшем – преобразователи) предназначены для линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, измерения и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве.

Преобразователи ЦВ 9057/1 – ЦВ 9057/4, ЦВ 9057/9, ЦВ 9057/10 предназначены, кроме того, для передачи результатов измерения с использованием порта RS-485.

Наличие двух встроенных реле позволяет осуществить коммутацию внешних цепей при принижении или превышении входным сигналом установленного порога срабатывания.

Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS, режим RTU.

Преобразователи могут применяться для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики различных отраслей промышленности.

ОПИСАНИЕ

Преобразователи конструктивно состоят из следующих основных узлов:

- верхней и нижней крышек корпуса;
- передней и задней панелей;
- платы АЦП;
- платы индикации;
- платы питания;
- платы выходов.

Верхняя и нижняя крышки, передняя и задняя панели образуют металлический корпус.

На передней панели расположены отсчетное устройство и светодиодные индикаторы, 5 кнопок управления, обозначенных символами "+", "-", ">", ">>", "S".

На задней панели расположены:

- разъем для подключения входных цепей и цепей питания;
- зажим защитного заземления (зажим ЗМ-3);
- разъем «RS – 485/Выход» (розетка DB – 9 – F);
- разъем «Настройка».

Фотография общего вида преобразователя приведена в приложении А.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа с указанием мест для нанесения оттисков клейм и расположения наклеек приведена в приложении Б.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Преобразователи ЦВ 9057 имеют 12 модификаций, отличающихся диапазоном выходного аналогового сигнала, также наличием или отсутствием аналогового выхода, порта RS-485, двух встроенных реле.

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип и модификация прибора	Диапазоны преобразуемого входного сигнала, Авх	Диапазон изменения выходного аналогового сигнала, мА	Диапазон сопротивления нагрузки, кОм	Наличие порта RS-485	Диапазон показаний отсчетного устройства	Наличие двух встроенных реле		
ЦВ 9057/1	0 – 60 В 0 – 100 В 0 – 150 В 0 – 250 В 0 – 500 В	0 – 5	0 – 3,0	Да	0 – 60 В 0 – 100 В 0 – 150 В 0 – 250 В 0 – 500 В	Да		
ЦВ 9057/2		4 – 20	0 – 0,5			Нет	Нет	
ЦВ 9057/3		0 – 5	0 – 3,0					
ЦВ 9057/4		4 – 20	0 – 0,5					
ЦВ 9057/5			0 – 5	0 – 3,0		Нет	Да	
ЦВ 9057/6			4 – 20	0 – 0,5			Нет	Нет
ЦВ 9057/7			0 – 5	0 – 3,0				
ЦВ 9057/8			4 – 20	0 – 0,5				
ЦВ 9057/9						Да	Да	
ЦВ 9057/10			-	-		Нет	Нет	
ЦВ 9057/11							Да	
ЦВ 9057/12							Нет	

2 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей равны $\pm 0,5$ % от нормирующего значения выходного сигнала.

Нормирующее значение по аналоговому выходу равно 5 мА для преобразователей с выходным сигналом 0 – 5 мА и 20 мА для преобразователей с выходным сигналом 4 – 20 мА.

Нормирующее значение по отсчетному устройству равно верхнему значению диапазона преобразуемого входного сигнала.

3 Допускаемый ток, коммутируемый каждым реле, 0,3 А.

Допускаемое напряжение, коммутируемое каждым реле, 250 В.

4 Питание преобразователей осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

5 Рабочие условия применения: температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 °С, относительная влажность воздуха 80 % при 25 °С.

6 Мощность, потребляемая преобразователем, не более:

- от измеряемой цепи: 1,0 В·А

- от источника питания 8 В·А.

7 Габаритные размеры 136х201х60 мм.

8 Масса не более 1,9 кг.

9 Средняя наработка на отказ - 33 000 ч.

10 Средний срок службы – 10 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится фотохимическим способом на лицевую панель преобразователя, а также типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- преобразователь (модификация по заказу потребителя);
 - паспорт;
 - руководство по эксплуатации;
 - методика поверки;
 - вилка DB-9-M;
 - кожух для вилки DB-9-M;
 - угольники, скобы, толкатель, винты и шайбы, необходимые для крепления преобразователей.
- Руководство по эксплуатации и методика поверки поставляются по 1 экз на 3 преобразователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ТУ РБ 300521831.017-2003 Преобразователи измерительные цифровые постоянного тока ЦА 9056 и напряжения постоянного тока ЦВ 9057. Технические условия;

МП.ВТ.069-2003 Преобразователи измерительные цифровые постоянного тока ЦА 9056 и напряжения постоянного тока ЦВ 9057. Методика поверки. Согласована с РУП «Витебский ЦСМС».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные цифровые напряжения постоянного тока ЦВ 9057 соответствуют ТУ РБ 300521831.017-2003.

Межповерочный интервал – не более 48 месяцев при использовании вне сферы законодательной метрологии.

РУП «Витебский ЦСМС», 210015 г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20.

Аттестат аккредитации № ВУ/ 112 02.6.0.0003 от 10.06.2008 г;

Научно-исследовательский центр испытаний средств измерений и техники
г. Минск, Старовиленский тракт 93,

Аттестат аккредитации №ВУ/112 02.1.0.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Союз»,
Республика Беларусь, 210601 г.Витебск, ул. С. Панковой 3,
ООО «Энерго-Союз», тел/факс (10375212) 24-62-41, 24-79-84
E-mail: energo@vitebsk.by

Представитель
РУП «Витебский ЦСМС»


подпись


расшифровка подписи

Директор ООО «Энерго-Союз»


подпись


Власенко С.С.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Фотография общего вида преобразователя

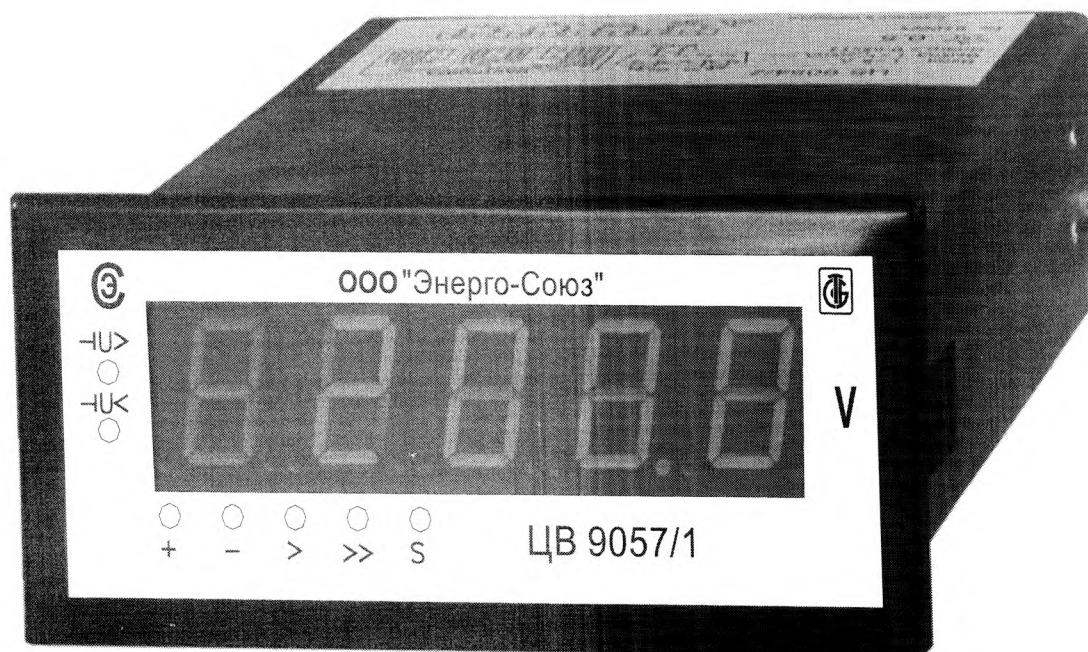


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)


Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение мест для нанесения оттисков клейм и размещения наклеек

Передняя панель преобразователя

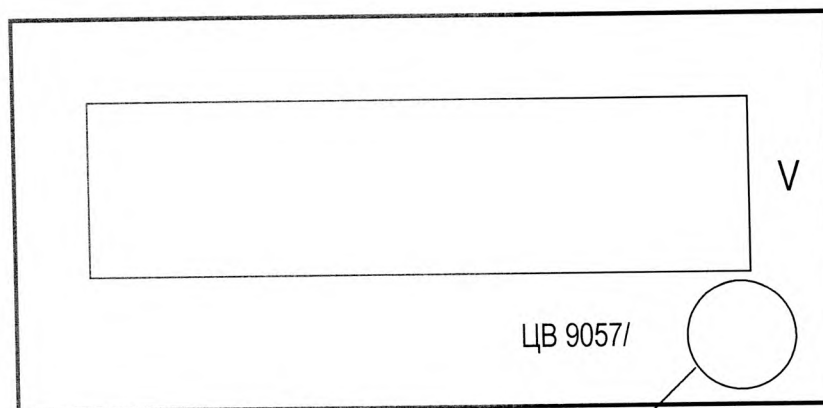

Место для нанесения клейма-наклейки поверителя

Задняя панель преобразователя

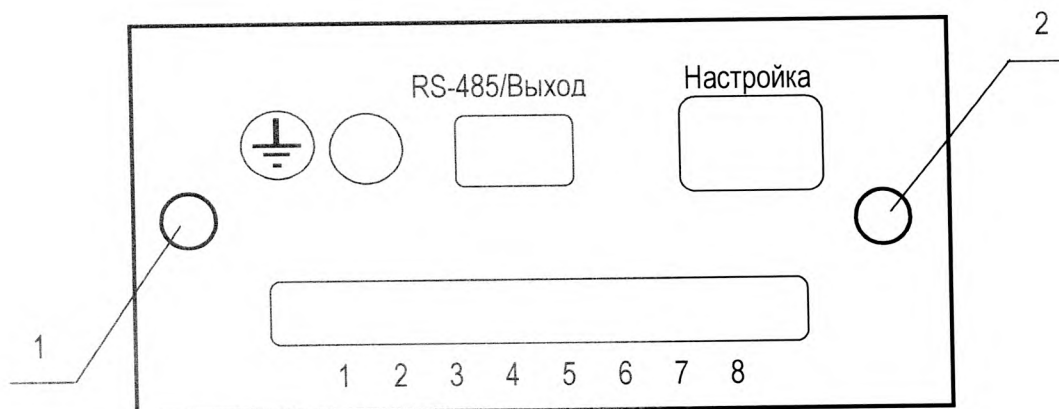

1 – Место для нанесения клейма ОТК

2 – Место для нанесения клейма поверителя